


Innovative Health Technologies



Hunter[®] ST

Cateter de Aspiração de Trombos

A eficácia vai além!

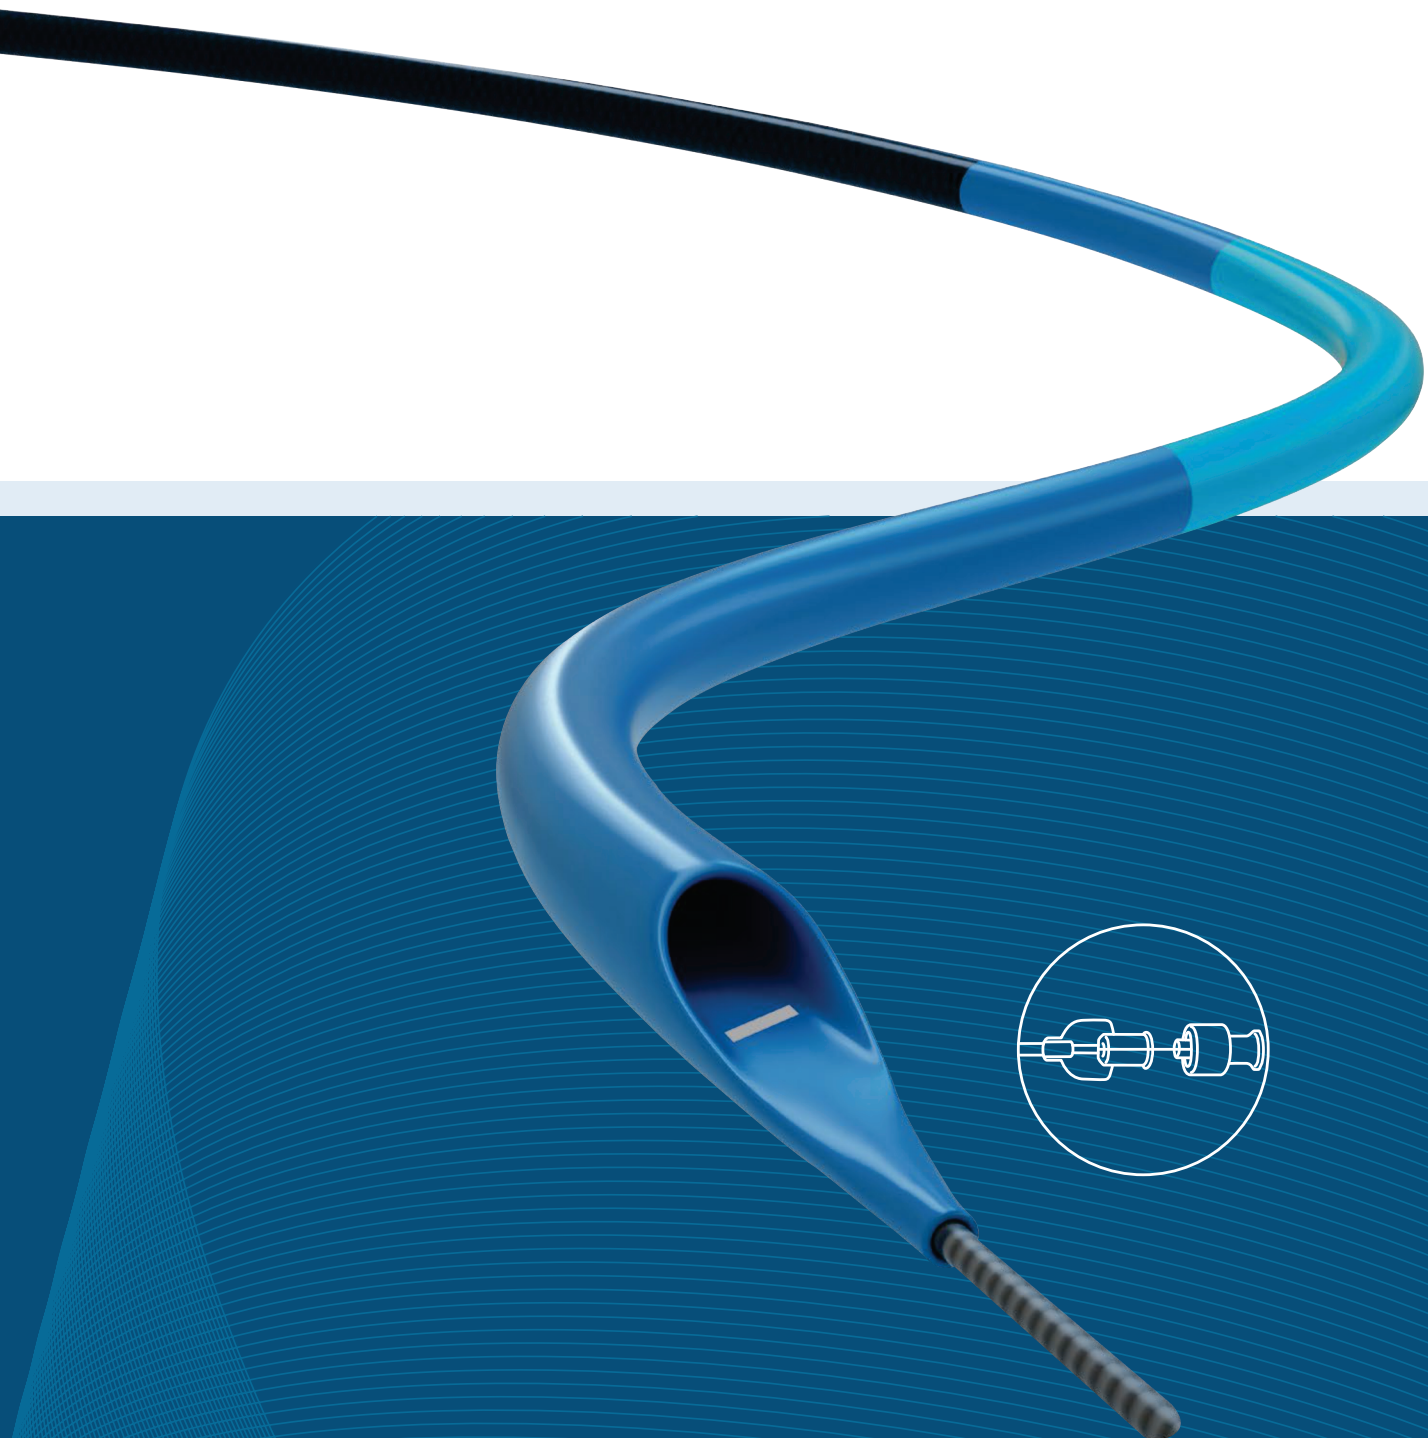

ÁREA PROXIMAL

Teflon, Malha Trançada e Revestimento Externo

Lúmen único e amplo, disponibilizando toda a sua superfície cilíndrica para a aspiração de trombos.

Ótimo deslizamento interno do trombo.

Malha plana, mais larga (oferecendo excelente *pushability*) e mais espessa (garantindo alta resistência ao *kink*), em comparação com os produtos concorrentes.

Estilete metálico pré-carregado para uma navegação ideal.

Compatível com cateter guia 6F ($1.40 + 0.32 = 1.72$).

ÁREA DISTAL COM DUPLO LÚMEN


Lúmen de Aspiração e Lúmen do Fio guia

Revestimento hidrofílico externo de Teflon.


Revestimento hidrofílico interno de Teflon tanto no lúmen de aspiração quanto no lúmen do fio guia, permitindo um deslizamento suave do guia e do trombo.

Marca radiopaca longitudinal, localizada distalmente a cerca de 5-8 mm da ponta.

Área de Extração Proximal **1.04 mm²**

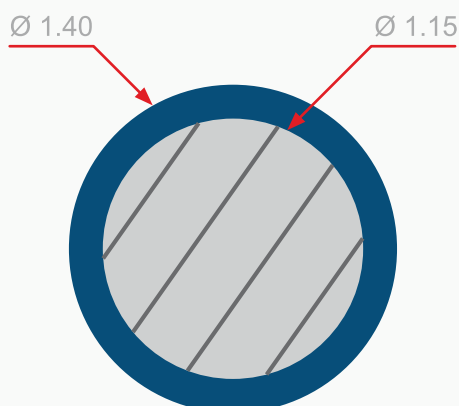

Área de Extração Distal **0.95 mm²**

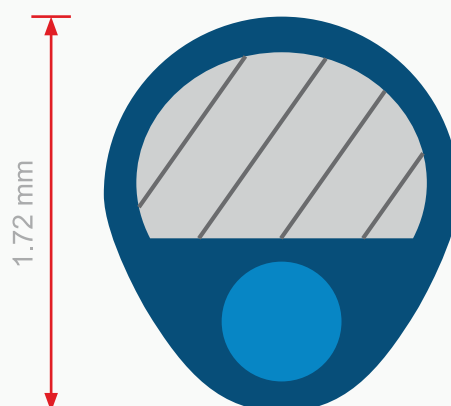


Entrada chanfrada para uma coleta de trombos eficiente e aprimorada.

Perfil de Entrada: 0.020"



ESTILETE

- Aço inoxidável
- Conexão *Luer Lock*
- Ponta arredondada atraumática
- Comprimento: 126 cm
- Diâmetro: 0.35 mm
- Flexibilidade homogênea

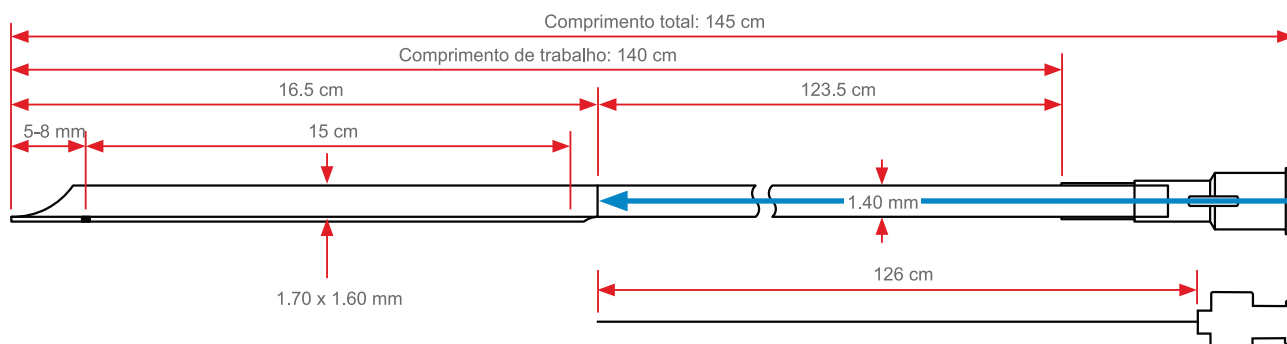

Hunter® ST

Especificações Técnicas

Marca radiopaca	1 marca distal (ponta)
Posição da marca radiopaca vs. lúmen de extração	5-8 mm da ponta
Comprimento da marca radiopaca	1.0 mm $\pm$ 0.2 mm
Cateter guia compatível	Compatível com cateter guia 6F que possua DE = 2 mm e DI $\geq$ 1.80 mm
Fio guia compatível	Fio guia 0.014" DI do lúmen $\geq$ 0.356"
Comprimento de trabalho	140 $\pm$ 3 cm
Perfil de entrada (diâmetro da ponta)	$\leq$ 0.015"
Perfil de cruzamento	$\leq$ 0.038"
Diâmetro externo distal	$\leq$ 1.70 mm
Diâmetro externo proximal	$\leq$ 1.44 mm ($\leq$ 1.80 mm com o fio guia)
Comprimento da ponta	2 mm
Distância braquial	88 $\pm$ 2 cm
Distância femoral	98 $\pm$ 2 cm
Diâmetro externo/ comprimento do estilete	0.36 $\pm$ 0.03 mm / 126.5 cm
Material biocompatível	Sem liberação de substâncias tóxicas

Número de Referência para Pedidos

0053850

Ref: 00961142
Rev: 2016-12-02

Hunter® ST é uma marca registrada da Iberhospitex S.A.

CUIDADO: A lei permite apenas a venda de dispositivos com certificado CE, autorizados pela Autoridade de Saúde competente, para uso por médicos e profissionais de saúde devidamente treinados.

Indicações, contraindicações, advertências e efeitos adversos resultantes do seu uso estão presentes no rótulo do produto ou nas instruções de uso fornecidas com cada dispositivo.

Essas informações são baseadas no conhecimento atual do produto e da ciência médica e são destinadas exclusivamente a profissionais de saúde.



Innovative Health Technologies

Iberhospitex S.A. Avda. Catalunya, 4 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Espanha
Tel +34 93 843 60 34 - Fax +34 93 843 61 11 - info@iht.es - www.iht.es

+ 55 11 5594-6908
www.laibomedical.com.br
comercial@laibomedical.com.br

